




Ingegneria Clinica

LOTTO 8

N.1 TAVOLO DI CONFEZIONAMENTO

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Società costruttrice | | |
| Modello dell'Apparecchiatura | | |
| Anno di produzione del modello | | |
| Descrizione: TAVOLO DI CONFEZIONAMENTO | caratteristiche tecniche minime obbligatorie | caratteristiche tecniche proposte |
| Realizzato in acciaio inox | AISI 304 | |
| Piano superiore liscio | spessore 15/10 | |
| Struttura tubolare possibilmente inox | SI | |
| Ripiano possibilmente inferiore liscio | SI | |
| Montato su n. 4 piedini regolabili | SI | |
| Parte superiore mensola appoggia strumenti | SI | |
| Dimensioni totali | Effettuare sopralluogo | |
| Cassettiera | n. 2 cassetti | |
| Trave elettrificata | SI | |

| | | |
|--|----|--|
| Pres a aria compressa | SI | |
| Lampada | SI | |
| Supporto porta rotolo | SI | |
| Pistola per aria compressa per strumentario cavo | SI | |

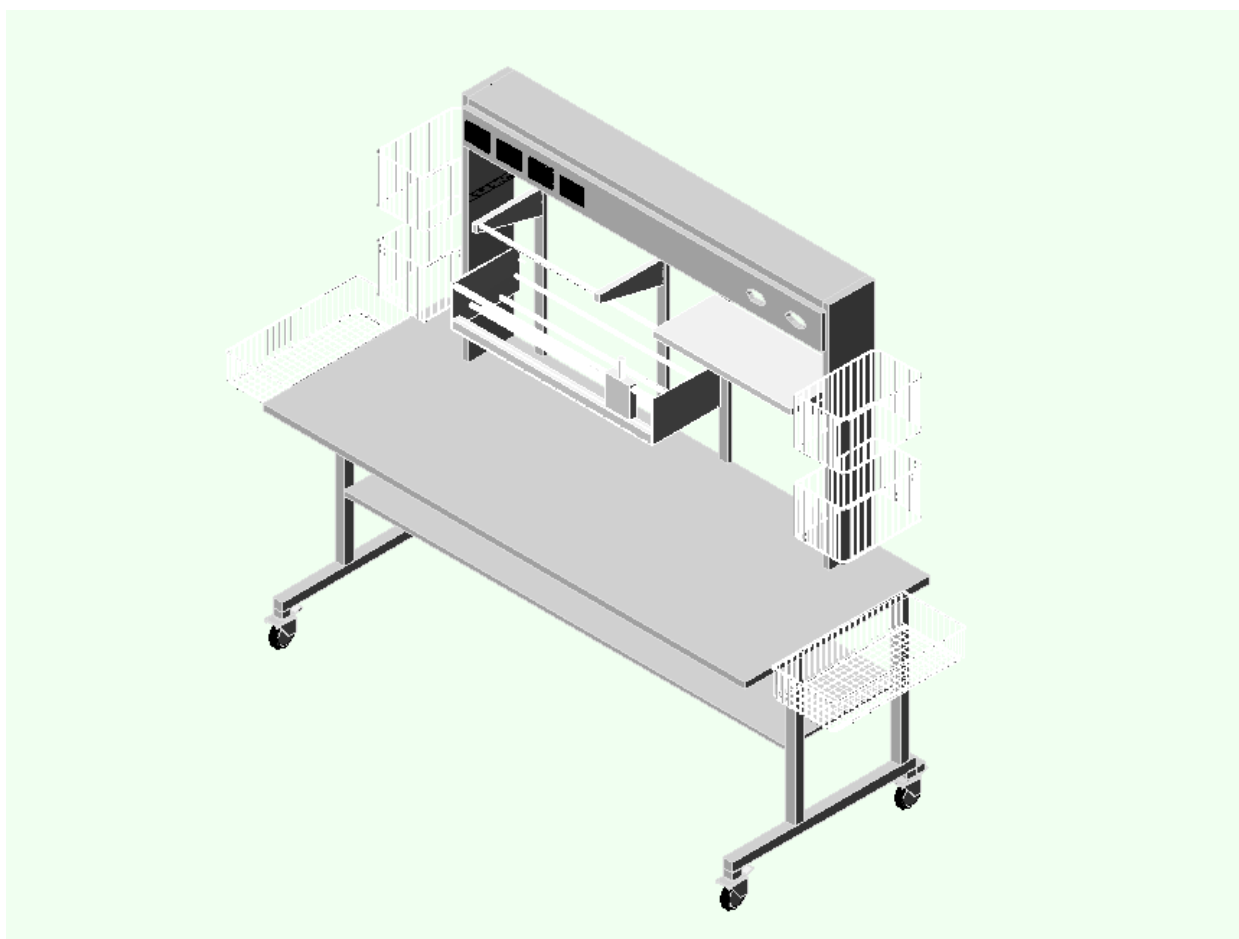

DISEGNO INDICATIVO

N.1 TERMOSALDATRICE

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Società costruttrice | | |
| Modello dell'Apparecchiatura | | |
| Anno di produzione del modello | | |
| Descrizione: TERMOSALDATRICE CONTINUA PER BUSTE DI STERILIZZAZIONE | caratteristiche tecniche minime obbligatorie | caratteristiche tecniche proposte |
| Polipropilene - polipropilene/carta - carta/carta - tyvek ed altri accoppiati termosaldabili | SI | |
| Gestione dati in rete per la tracciabilità dei percorsi di confezionamento | SI | |
| Accessori | Piano di scorrimento in acciaio inox Rulliera di scorrimento | |

N.1 LAVAFERRI PER STRUMENTARIO CHIRURGICO

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Società costruttrice | | |
| Modello dell'Apparecchiatura | | |
| Anno di produzione del modello | | |
| Descrizione: LAVAFERRI PER STRUMENTARIO CHIRURGICO | caratteristiche tecniche minime obbligatorie | caratteristiche tecniche proposte |
| Apparecchiatura automatica da incasso per il lavaggio, il risciacquo, la disinfezione e l'asciugatura di strumentario chirurgico, zoccoli e container | SI | |
| Rivestimento esterno in acciaio inox a doppia parete | AISI 304 | |
| Dimensioni esterne orientative | LxPxH 900x600x800 mm (DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO) | |
| Due sistemi di lavaggio indipendenti | SI | |
| Programmazione elettronica | Standard o da utente | |
| Programmi memorizzabili | SI | |
| Vasca di lavaggio/porta in acciaio inox AISI 316L, antiacido al nichel cromo | SI | |

| | | |
|---|--|--|
| | | |
| Pompa di ricircolo | SI | |
| Sistema di asciugatura ad aria termostattizzata | SI | |
| Temperatura di lavaggio e risciacquo programmabile | Da 20° a 93° circa | |
| Temperatura di asciugatura programmabile | Da 20° a 110° circa | |
| Mobiletto integrato porta detergenti | SI | |
| Alloggiamento due taniche da 5 litri o quattro da 2 litri per detergente | SI | |
| Addolcitore rigenerazione volumetrica automatica | SI | |
| Sistema di controllo della temperatura con visualizzazione su display | SI | |
| Sicurezze | arresto lavaggio apertura porta, controllo livelli acqua, sicurezza riscaldamento, | |
| Condensatore di vapore incorporato | SI | |
| Asciugatura Drying System | SI | |
| Alimentazione elettrica trifase | Assorbimento circa 7 Kw | |
| Completa di cestelli assortiti per il lavaggio dello strumentario chirurgico | SI | |
| Stampante | Con riscontro avvenuto ciclo | |
| Funzionamento sia elettrico che con immissione di vapore diretto dall'esterno | SI | |
| Accessori | carrelli con contenitori per strumentario: N.1 carrello per strumentario laparoscopico, N.1 carrello per strumentario endoscopico, N.1 carrello presidi cavi; n.2 contenitori per decontaminazione dello strumentario con griglia estraibile; | |
| | | |

N.1 BANCO LAVELLO CON PREDISPOSIZIONE LAVAFERRI

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Società costruttrice | | |
| Modello dell'Apparecchiatura | | |
| Anno di produzione del modello | | |
| Descrizione: BANCO LAVELLO CON PREDISPOSIZIONE LAVAFERRI | caratteristiche tecniche minime obbligatorie | caratteristiche tecniche proposte |
| Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 | Piano superiore liscio spessore 18/10 | |
| Alzatina posteriore | mm. 100 circa | |
| n.2 vasche lavello complete di piletta, sifone, miscelatore | mm.500x400x300h circa | |
| n.1 vano per predisposizione lavaferri | SI | |
| Vano sottostante chiuso perimetralmente su tre lati | SI | |
| Montaggio su piedini regolabili | SI | |
| Finitura scotch brite | SI | |
| Completa di piletta e sifone. Gruppo erogatore e miscelatore | SI | |
| Dimensioni | Da indicare in fase di sopralluogo | |
| Contenitore per decontaminazione dello strumentario | N.4 | |
| Pistola x aria compressa con accessori | N. 1 | |

